

Cell Cycle Assay Kit (Blue Fluorescence)

Cat. No: GCQ0058

Size: 20 Assays/50 Assays/100 Assays

产品编号	产品名称	20 Assays	50 Assays	100 Assays	Storage
E-CK-A351A	RNase A Reagent	1 mL×2	5 mL×1	10 mL×1	-20°C
E-CK-A353A	Cycle Blue Reagent	8 mL×1	10 mL×2	10 mL×4	-20°C, shading light

保存条件


RNase A Reagent 适当分装后-20°C 可保存 1 年。Cycle Blue Reagent -20°C 避光可保存 1 年。

检测原理

Elabscience®的 Cell Cycle Assay Kit (Blue Fluorescence)是通过检测 DNA 含量来检测细胞周期的试剂盒。本试剂盒可应用于培养细胞（悬浮、贴壁）的 DNA 含量（细胞周期）检测。

细胞周期(cell cycle)是指连续分裂细胞从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂结束所经历的整个过程。在这个过程中，细胞遗传物质复制并加倍，且在分裂结束时平均分配到两个子细胞中去。细胞周期可以分为分裂间期(interphase)和有丝分裂期(M phase), 分裂间期又可以细分为休眠期(G0), DNA 合成前期(G1), DNA 合成期(S), DNA 合成后期(G2)。利用细胞内 DNA 能够和某些特定荧光染料（如 Cycle Blue）结合的特性，细胞各个时期其 DNA 含量不同从而结合的荧光染料的量不同，通过流式细胞仪检测荧光强度即可反映细胞周期变化情况。

Cycle Blue 染色后，假设 G0/G1 期细胞的荧光强度为 1，那么含有双份基因组 DNA 的 G2/M 期细胞的荧光强度的理论值为 2，正在进行 DNA 复制的 S 期细胞的荧光强度为 1~2 之间。凋亡细胞由于细胞核发生浓缩以及 DNA 片段化(DNA fragmentation)导致部分基因组 DNA 片段在染色过程中丢失，因此凋亡细胞在 Cycle Blue 染色后呈现明显的弱染，即荧光强度小于 1，在流式检测的结果图上出现所谓的 sub-G1 峰，即凋亡细胞峰。

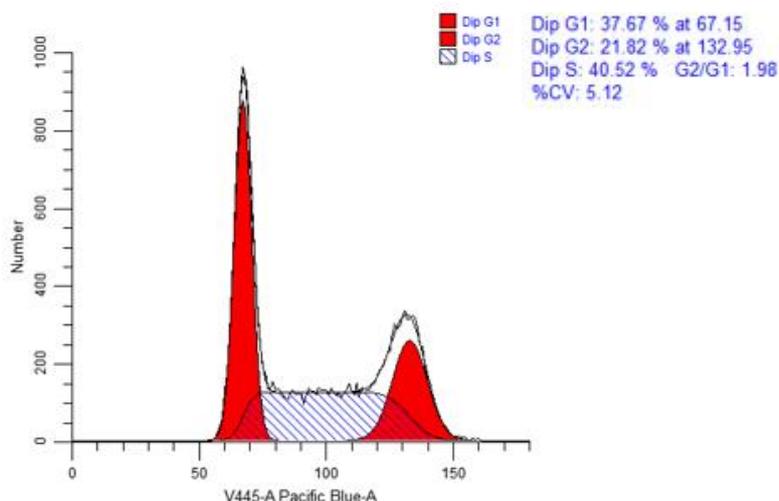

本试剂盒检测经 70%乙醇固定过夜后的 Jurkat 细胞周期

For Research Use Only

实验操作指南

1. 准备工作

- A. 无水乙醇-20°C 冰箱过夜。
- B. RNase A Reagent 溶解后混匀，冰浴备用。

2. 样本处理

- 1) 按实验方案对细胞进行处理后，收集约 5×10^5 细胞。
 - 2) 300×g 离心 5 min，弃上清。
 - 3) 加入 1 mL PBS 洗涤，300×g 离心 5 min，弃上清。
 - 4) 加入 0.3 mL 的 PBS 重悬细胞。
3. 加入 0.7 mL 的-20°C 无水乙醇，充分混匀后置于-20°C 冰箱中 1h 或过夜。
 4. 300×g 离心 5 min，弃上清，加入 1 mL 的 PBS 重悬细胞，室温放置 15 min。
 5. 300×g 离心 5 min，弃上清，加入 100 μ L 的 RNase A Reagent 并充分悬浮细胞，37°C 水浴 30 min。
 6. 加入 400 μ L 的 Cycle Blue Reagent 并充分混匀，2-8°C 避光孵育 30 min。
 7. 立即上机检测，Cycle Blue 的最大激发波长是 364nm，最大发射波长是 454nm。

注意事项

1. 保质期 1 年。为获得最佳的使用效果，请在 3-6 个月内使用。
2. 实验结果需用流式细胞仪进行检测。
3. 荧光物质均易发生淬灭，在进行荧光观察时，尽量缩短观察时间，同时在操作和存放过程中也尽量注意避光。
4. Cycle Blue Reagent 对人体有刺激，操作时请小心，并注意适当防护以免直接接触人体或吸入体内。
5. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。